



МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

**ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ
АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР**

Б корпус, Засгийн газрын IX байр,
Энхтайваны өргөн чөлөө 16, Баянзүрх дүүрэг,
Улаанбаатар хот, 13381
Утас/Факс: (976-51) 26 00 62
Цахим шуудан: info@spa.gov.mn
Цахим хуудас: www.spa.gov.mn

2024.04.12 № A-1/1544

танай _____-ны № _____-т

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД

Тус газраас зарласан ЭМЯ/20240102074 дугаартай XVIII.3.37 “Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн автомашин, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/” төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтад оролцохыг сонирхогч этгээдээс ирүүлсэн тодруулгад захиалагч Эрүүл мэндийн яамнаас ирүүлсэн тодруулгын хариуг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт: 2 хуудастай.

ДАРГА



Ц.БАТЗУЛ

1324030507



**МОНГОЛ УЛСЫН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ**

14210 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
Олимпийн гудамж 2, Засгийн газрын VIII байр.
Утас: 26-36-95, Факс: (976-11) 32-35-41
И-мэйл: moh@moh.gov.mn, http://www.moh.gov.mn

2024. 04. 04 № 21366
танай _____-ны № _____-т

**ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ
АЖИЛЛААГААНЫ ГАЗРЫН ДАРГА
Ц.БАТЗУЛ ТАНАА**


Танай ирүүлсэн А-1/1351 дугаар албан бичигтэй танилцлаа.

Танай газарт зарласан ЭМЯ/20240102074 дугаартай XVIII.3.37 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн автомашин, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтын явцад гарсан тодруулгыг судлан үзэж, хариуг хавсралтаар хүргэж байна.

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА  Д.ОЧИРБАТ



146241071

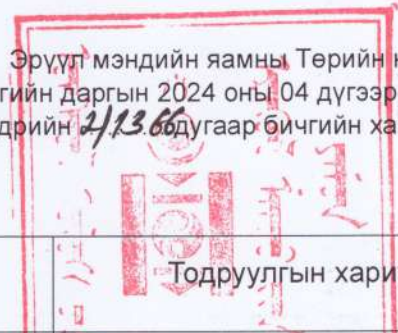

Тендерийн баримт бичиг	Асуулт	Тодруулгын хариу
Биохимийн бүрэн автомат анализатор	<p>Тухайн тоног төхөөрөмж нь бүрэн автомат эсвэл хагас автомат ажиллагаатай эсэх</p> <p>Бидний зүгээс (цагт 100 шинжилгээ хийх) өнгөт мэдрэгчтэй дэлгэцтэй бүрэн автомат анализатор санал болгож байгаа нь тендерийн техникийн тодорхойлолтыг хангах эсэх</p>	<p>Тус аппарат нь бүрэн автомат ажиллагаатай биохимийн бүрэн автомат анализатор байна.</p> <p>Санал болгож байгаа бүрэн автомат анализатор нь цагт 100 болон түүнээс дээш шинжилгээ хийх ямар ч аппарат байж болно.</p>
Шээсний анализатор -Хурд: 240 тест /цагт хийдэг байх/	<p>Тус анализаторыг ашиглах өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд нь өдөрт хэдэн хүнд шээсний шинжилгээ хийх вэ?</p>	<p>Өрхийн Эрүүл мэндийн төвүүд шаардлагатай тохиолдолд бусад тоног төхөөрөмж дутагдалтай ӨЭМТ, ЭМБ-ийн шинжилгээг хийх тул санал болгож буй шээсний анализатор цагт 240 тест болон түүнээс дээш шинжилгээ хийх аппарат байх хэрэгтэй.</p>
Хэрэглэгдэх стрип тест: Н14-Са (Н-800), Н13-Сг (Н-800), Н12-800Ма, Н11-800Ма, Н10-800, Н11-800 гэсэн сонголттой байх	<p>Бидний санал болгох анализатор нь 14 үзүүлэлтээр шинжилгээ хийдэг бөгөөд тухайн лаборатори өөрийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн тохирох 10/11/14 үзүүлэлтийг сонгон ашиглах боломжтой тул тендерийн техникийн тодорхойлолтыг хангах эсэх</p>	<p>Тухайн санал болгож байгаа Шээсний анализатор нь 14 үзүүлэлтээр шинжилгээ хийх хийх ямар ч аппарат байж болно.</p>