

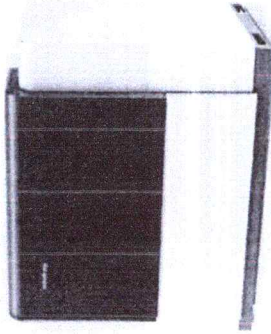
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГ УУЛЛАГАД ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ /УЛСЫН ТАСОВ/





ЗАСАГ ДАРГА П.ЛХАГВАЖАВ

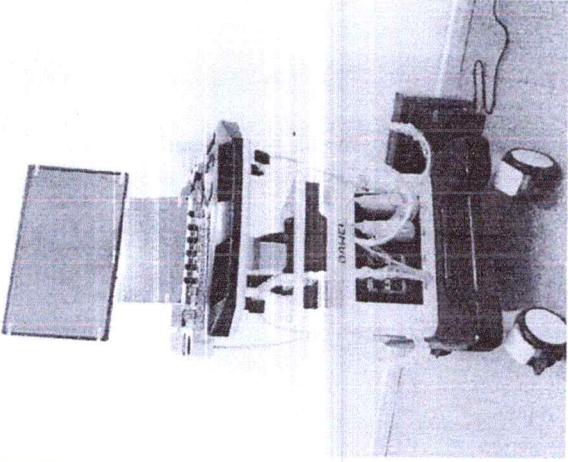
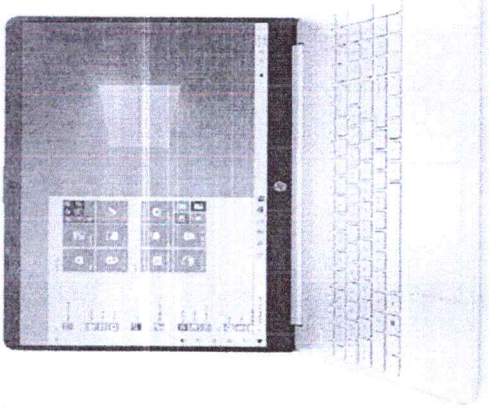
БАТЛАВ

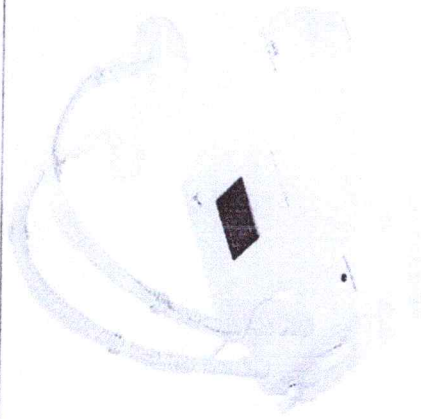
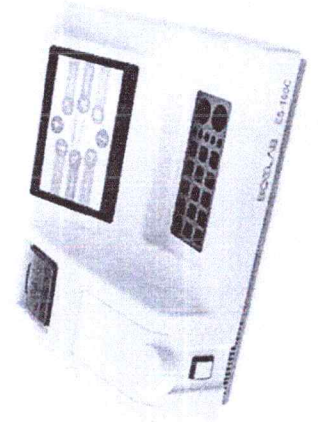
2024-01-15

PIOA0107 9070354

д/д	Тоног тохөөрөмжийн төрөл	Тоо ширхэг	Нэг бүрийн үнэ	Нийт үнэ	Техникийн тодорхойлолт	Зураг
1	Бүлэгнэлтийн шинжилгээний бүрэн автомат анализатор	1	71 сая	71,000,000 төг	<ul style="list-style-type: none"> Ажиллагаа: Бүрэн автомат Хэмжих зарчим: Механик арга болон оптик арга (575nm) Хүчин чадал: PT: 200 шинжилгээ/цаг, D-dimer: 52 шинжилгээ/цаг Шинжилгээний үзүүлэлтүүд: PT, APTT, Fib, TT, D-Dimer, FDP, Factors II, V, VII, X, XI, XII, vWF Сорьцын тавиур: LED индикатор бүхий 61 сорьцын тавиуртай Урвалжийн тавиур: 11 урвалжийн тавиуртай, үүнээс 10 нь LED индикатортой, 2 нь холих системтэй Кювет ачаалах багтаамж: 1000 кювет Сорьцын систем: Сорьц болон урвалж сорох тусдаа зүүтэй, Сорох зүү бүр нь шингэн мэдрэгчтэй, Урвалж сорох зүү нь халаах системтэй Хэмжээ: 583мм*691мм*589мм Жин: 62кг Нэмэлт дагалдах хэрэгслүүд: Компьютер болон Тог баригч, принтер дагалдуулна Нийлүүлэхээр санал болгосон аппаратын урвалж бодисыг ханган нийлүүлэх 	

2	Нярайн шарлалт хэмжигч	28	3.5 сая төг	98,000,000 төг	<p>боломжтой, Урвалж, оношлуур импортлох, ханган нийлүүлэх тусгай зөвшөөрөлтэй</p> <p>Загвар: AJ20</p> <p>Гарал үүсэл: Хятад улс</p> <p>Дэлгэрэнгүй үзүүлэлт:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LCD дэлгэцтэй. • 1,5 В 2 ширхэг баттөрийгаар ажиллана. • Хэмжилтийн түвшин: 0.0-30.0 mg/dL • Бэлтгэх хугацаа: 12 сек • Хэмжилтийн үр дүнг халгална. 	
3	Нярайн шарлалтын аппарат	26	3.5 сая	91,000,000 төг	<p>Загвар: BT-400</p> <p>Гарал үүсэл: Солонгос улс</p> <p>Дэлгэрэнгүй үзүүлэлт:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Хэмжээ: 34*21*7.5 см • Жин: 3.6 кг • Ашиглалтын температур: 10-40°C • Ашиглалтын чийгшил: 5-85 % конденсаций. • 2.4 инчийн TFT өнгөт LCD дэлгэц. • Оролт: 100-240 В, 50 / 60 Гц • LED ламп ашиглалтын хугацаа: 100000 цаг • Долгионы урт: дээд хэмжээ 450 - 465 нм • Эрчимтэй хэлбэлзэл: ± 10% (6 цагаас дээш) • Нэг жигд тархалтын эрчим: бага 20 - 35uW / см 2 / нм ± 10% • Өндөр (40см-т) өндөр: 35 - 55uW / см 2 / нм± 10% 	  

4	3,4,5 D онгог суурин ЭХО аппарат	3	50,0 сая	150,000,000 төг	<p>21.5 инчийн LED дэлгэц + 13.3 инчийн мэдрэгчтэй дэлгэцтэй.</p> <p>Windows 8 үйлдлийн системтэй.</p> <p>Дөрвөн датчигний оролттой.</p> <p>Олон төрлийн хэмжилтийн програм хангамжтай.</p> <p>Элемент : 128</p> <p>PW, CW, 4D+Real Skin</p> <p>Трапецын дүрслэл, Импульсийн автомат хэмжилт</p> <p>Өнгөт принтер холбох боломжтой.</p> <p>CD driver-тай.</p> <p>Хэлний сонголт: БНХАУ, Англи, Орос</p> <p>Хэмжээ: 104x73x156 см</p> <p>Жин: 130 кг</p>	
5	Зөөврийн компьютер	31	3,5 сая	108,500,000 төг	<p>DELL New Inspiron 15 3520</p> <ul style="list-style-type: none"> • Үйлдлийн систем / OS: Windows 11 Home Single Language (64bit) • Процессор / CPU: 13th Generation Intel® Core™ i7-1355U (5.0GHz) • Шуурхай санах ой / RAM: 8GB, 1x8 GB. • Дэлгэц: 15.6-inch, HD, 1366 x 768, 60 Hz, anti-glare, LED backlight, non-touch, 45% NTSC, 220 nits • Графикак: Intel® UHD Graphics • Багтаамж /SSD/: 512GB SSD • CD/DVD уншигч: No Optical Drive • Интерфэйс: <ul style="list-style-type: none"> • 1 USB 2.0 port • 2 USB 3.2 Gen 1 ports • 1 Headset (headphone and microphone combo) port • 1 HDMI 1.4 port • 1 Power-adapter port 	

					<ul style="list-style-type: none"> • 1 SD Media Card Reader • Камер / Микрофон: 720p at 30 fps HD camera Single-array microphone • Wireless / Утасгүй сүлжээ: 802.11ac 1x1 WiFi and Bluetooth • Speaker: Stereo speakers with Waves MaxxAudio® Pro, 2.5 W x 2 = 5 W total • Power: 45 Watt AC Adapter (with standard graphics) • Батерей: 3-Cell 42Whr Battery (Integrated) • Хэмжээ: Height: 18.0 mm – 19.9 mm (0.71" – 0.78") Width: 363.96 mm (14.33") Depth: 249 mm (9.80") • Жин: 1.83кг • Баталгаа - 24 сар 							
<p>6</p> <p>УВЧ-30.01 шарлагын аппарат</p> <p>2</p>		4	6,5 сая	26,000,000 Төг	<ul style="list-style-type: none"> • Гарал үүсэл : ОХУ • Дэлгэрэнгүй үзүүлэлт: • Цаг тохируулах хурээ: 0-99 мин • Цахилгаан соронзон долгионы давтамж: 27.12 ± 0.16 МГц • Гаралтын чадал: 10/15/20/30/40/50/60 Вт ± 20% • Цахилгаан тэжээл: 220 В, 50 Гц • Чадал: 250 Вт • Хэмжээ : 421×285×170 мм • Жин : 7.5 кг 							
7	Биохимийн хагас автомат анализатор	19	24,0 сая	456,000,000 Төг	<table border="1"> <tr> <td>Урвалж ийн систем:</td> <td>Гар ажиллагаа шаарддаггүй хуурай урвалжийн системтэй байх</td> </tr> <tr> <td>Сорьц:</td> <td>Сийвэн, Ийлдэс</td> </tr> <tr> <td>Параметр:</td> <td>Glucose, UA, T-Cholesterol, TG, BUN, T-Bilirubin, Calcium, TP, Alb, GOT, GPT, LDH, CPK,</td> </tr> </table>	Урвалж ийн систем:	Гар ажиллагаа шаарддаггүй хуурай урвалжийн системтэй байх	Сорьц:	Сийвэн, Ийлдэс	Параметр:	Glucose, UA, T-Cholesterol, TG, BUN, T-Bilirubin, Calcium, TP, Alb, GOT, GPT, LDH, CPK,	
Урвалж ийн систем:	Гар ажиллагаа шаарддаггүй хуурай урвалжийн системтэй байх											
Сорьц:	Сийвэн, Ийлдэс											
Параметр:	Glucose, UA, T-Cholesterol, TG, BUN, T-Bilirubin, Calcium, TP, Alb, GOT, GPT, LDH, CPK,											

	Amy, GGT, ALP, Cre, HDL-C, FRA, IP, Mg	Нэг зэрэг хамгийн байгадаа 9 хүртэлх үзүүлэлт хэмжих боломжтой байх	Паратетрүүдийг нэг нэгээр болон багц параметр хэмжих боломжтой байх	Гэрлийн тусгалын эрчмийн оптик хэмжилт	Цагт 63 үзүүлэлт түүнээс их	Сорох үзүүлэлтэнд 4-6 uL түүнтэй дүйцэхүйц	Магнетик карт ашиглан богино хугацаанд калибраци хийдэг байх	Асаад бэлэн болох хугацаа: хамгийн ихтэй 10 мин	Гэрлийн үүсгүүр: Хугацаат солих шаардлаггүй LED гэрэл + Interference filter	Детектор: Silicon photodiode	Хэмжилтийн долгион: 405, 550, 575, 610, 820 nm

Урвалын температур урын хяналт:	37±0.1
Жин:	бкг-аас ихгүй байх
	Өр дээр жижиг центрифугтай байх
	Дотоод сүлжээнд холбогддог байх
	Зөөвөрлөх боломжтой байх
Бусад:	Засвар үйлчилгээ шаардахгүй байх
	Өр дээр хэвлэгчтэй байх
	Монгол Улсад өргөн хэрэглэдэг байх
	Монгол Улсад албан ёсны дистрибьютертэй байх
Баталгаат хугацаа:	24 сар

Дээрх 7 төрлийн 112 ширхэг тоног төхөөрөмж 1,000,000,000 төгрөг

ХЯНАСАН:
 НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА
 БОЛОВСРУУЛСАН: **Б. БАТБИЛГҮҮН**
 НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОДЛОГО
 ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН **О.ДАГИЙМАА**