

“УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ” ТӨХК-НИЙ
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



Ш.МӨНХЖАРГАЛ


2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН
ТООЦООЛОГЧИЙН ТЕМПЕРАТУРЫН ДАТЧИК ШАЛГАХ ХАЛУУН УСАН ВАНН

| № | Тоноглолын нэр | Төрөл | Тоо хэмжээ | Фото зураг |
|---|---|-----------------------------------|------------|------------|
| 1 | ТООЦООЛОГЧИЙН ТЕМПЕРАТУРЫН ДАТЧИК ШАЛГАХ ХАЛУУН УСАН ВАНН | Thermo, Grant маягийн халуун ванн | 1 ширхэг | |

| | Гадна харагдах байдал | Дотор харагдах байдал |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 2 | | |

Банны таг нь 5ширхэг температурын датчик суух үүртэй байна

3

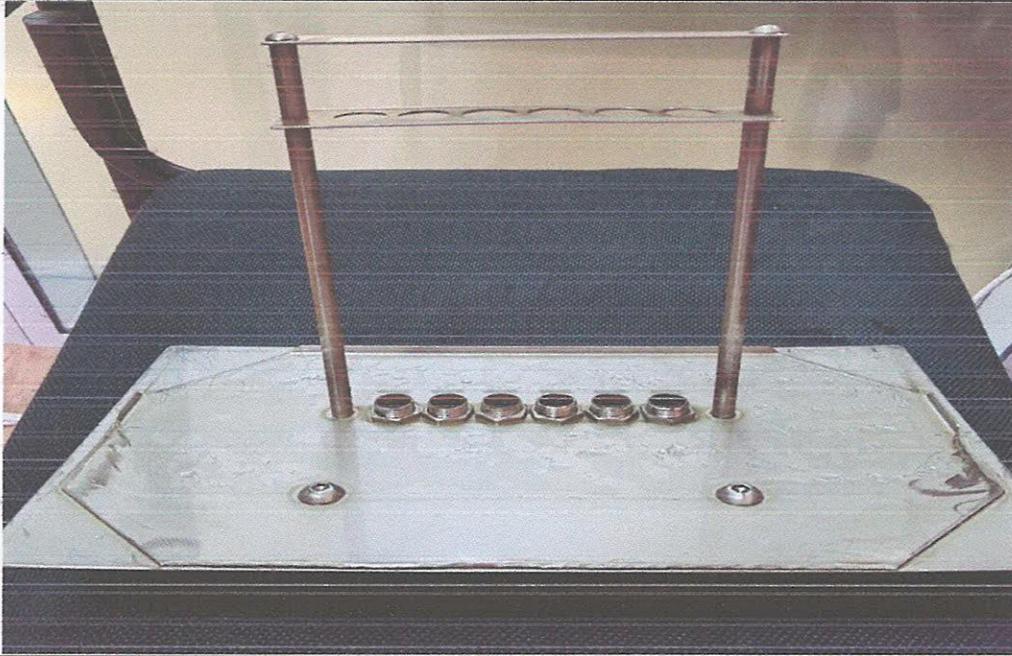

Тавигдах шаардлага:

1. Ажлын бие халаах температур $+0 \sim +100^{\circ}\text{C}$
2. Зэвэрдэггүй ган /Нерж/ байна.
3. 220В тэжээлтэй байх.
4. Ус халаах, 15-25 литр багтаамжтай
5. Усаа сэлгэж тогтмол температураа барих үлээгчтэй байна.
6. Температурын олон утганд тохируулж сануулах боломжтой байх
7. Таг нь температурын 5 ширхэг датчик хийх нүхтэй, суурьтай байна
8. Засвар ашиглалтын заавар монгол хэл дээр байх
9. ISO9001 олон улсын чанарын стандарт шаардлага хангасан байх.

Жич: Нийлүүлэгч компани нь угсралтын ажлыг хийх, мөн жилийн баталгаа өгөх

ХЯНАСАН:

Дотоод хяналт, аюулгүй ажиллагааны

хэлтсийн дарга:

/М.Доржпалам/

БОЛОВСРУУЛСАН

Дулаан, даралтын хэмжих хэрэгслийн

лабораторийн эрхлэгч

/Д.Бямбатер/



“УЛААНБААТАР ДУДААНЫ СҮЛЖЭЭ” ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Ш.МӨНХЖАРГАЛ

2024 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН

Пульс тоологч /Calibration counter H7CX/

| № | Тоноглолын нэр | Төрөл | Тоо хэмжээ | Фото зураг |
|---|------------------|----------------------------------|--------------|---|
| 1 | ПУЛЬС ТООЛОГЧ | /Calibration counter H7CX/ | Иж бүрдэл |  |

Гадна, дотор харагдах байдлын зураг

| | Гадна тал хуурмаг зарцуулалт гаргах утас, импульс тоологч | Гаралтын хүчдэл тохируулагч, тэглэх /reset/, эхлүүлэх/start/ товчнууд |
|---|---|--|
| 2 |  |  |



Тавигдах шаардлага:

1. Доторх бүх деталиудыг хайрцагт угсарч бэлтгэнэ
2. Импульсийн сигнал тоолох /calibration counter/ пульс тоологчтой байх
3. 220V тэжээлтэй байна
4. 12V – 24V гаргах генератортай байх.
5. Хуурмаг зарцуулалт гаргах генераторын гаралттай байх /нэг зэрэг 5 тооцоологч угсрах холболтын утастай/.
6. Зарцуулалтын утгыг тохируулах /frekvens set/ боломжтой байх.
7. Унтраалга, импульсийн сигналийг тэглэх /reset/, эхлүүлэх /Start/ товчтой байх.
8. ISO9001 олон улсын чанарын стандарт шаардлага хангасан байх.

Жич: Нийлүүлэгч компани нь угсралтын ажлыг хийх, мөн жилийн баталгаа өгнө.

ХЯНАСАН:

Дотоод хяналт, аюулгүй ажиллагааны

хэлтсийн дарга:



/М.Доржпалам/

БОЛОВСРУУЛСАН

Дулаан, даралтын хэмжих хэрэгслийн

лабораторийн эрхлэгч



/Д.Бямбатер/